

Ordem de Compra



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



ANÁPOLIS
Orgulho de viver aqui



INDSH

ORDEM DE COMPRA Nº: 20221118-1

18/11/2022

COMPRADOR RESPONSÁVEL

NOME: CAIO MILHOMEM

EMAIL: compras.upaalair@indsh.org.br

MAPA DE COTAÇÃO: Nº: 20221118-1

CLIENTE

CNPJ: 23.453.830/0025-47

FANTASIA: UPA III DR. ALAIR MAFRA ANDRADE

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND SH

ENDEREÇO: RUA 29 DEZEMBRO S/N. VILA ESPERANÇA, ANÁPOLIS - GO - CEP: 75.133 - 450

CONTATO: CAIO MILHOMEM

TELEFONE: (62) 9486-9149

ENDEREÇO DE ENTREGA

UPA III DR. ALAIR MAFRA DE ANDRADE

ENDEREÇO: RUA 29 DEZEMBRO S/N. VILA ESPERANÇA, ANÁPOLIS - GO - CEP: 75.133 - 450

CONTATO: CAIO MILHOMEM

TELEFONE: (62) 9486-9149

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: APIJÁ PRODUTOS LABORATORIAIS

CNPJ: 02.364.952/0001-97

CONTATO:

CONTATO TELEFONE: (62) 3086-5250

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE	VALOR UNIT.	R\$ TOTAL
1	COAGULOMETRO	1	R\$ 3.017,00	R\$ 3.017,00
2	ANALISADOR DE BIOQUIMICA	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
3	GASOMETRIA (CONSUMO MINIMO)	300	R\$ 18,95	R\$ 5.685,00
4	HEMATOLOGIA (EXAMES DE HEMOGRAMA) CONSUMO MINIMO	3123	R\$ 4,40	R\$ 13.741,20

OBSERVAÇÕES:

NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 24 HORAS ÚTEIS.

O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARRETER NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO.

OBRIGATORIAMENTE A NOTA DEVE SEGUIR TODAS AS CONDIÇÕES E PREÇOS NEGOCIADOS CONFORME ESTE PEDIDO.

OBRIGATORIAMENTE A NOTA FISCAL DE CONTER A DESCRIÇÃO DO NÚMERO DESTA PEDIDO EM SUAS OBSERVAÇÕES.

DESCONTOS	R\$ -
FRETE	
VALORTOTAL	R\$ 33.443,20
COND.PAGTO	CONTRATO
VENCIMENTO	
PZO ENT.	1
FRETE	CIF

Caio A. Milhomem
Responsável Compras

Kelia Marçal
Coord. Adm/Finan

Allan Sebata
Gerente Adm.Financ.

Sebastião Bismarques
Diretor Executivo

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ: 23.453.330/0023 - 47
FANTASIA: UPA III ALAIR MAFRA ANDRADE
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: Av. Rua 29 de Dezembro Bairro: Vila Esperança Cidade: Anápolis - GO.
CONTATO: CAIO MILHOMEM
TELEFONE: Cel: 62 99280-4776

E-MAIL: NF-e: compras.upa@indsb.org.br

CEP: 75133-450

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento



NUMERO DO MAPA DE COTAÇÃO

CONTRATO MAQUINAS LABORATORIO

sexta-feira, 18 de novembro de 2022

MC 20221118-1

SELA

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

NOME DA EMPRESA

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

TELEFONE

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

E-MAIL

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

DESCRIÇÃO

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

QUANT

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

VALOR UNIT

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

TOTAL

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

ANALISADOR DE BIOCQUIMICA

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

ANALISADOR DE BIOCQUIMICA

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

GASOMETRIA (CONSUMO MINIMO)

300

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

GASOMETRIA (CONSUMO MINIMO)

300

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

GASOMETRIA (CONSUMO MINIMO)

300

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

GASOMETRIA (CONSUMO MINIMO)

300

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

HEMATOLOGIA (EXAMES DE HEMOGRAMA) CONSUMO MINIMO

3123

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

HEMATOLOGIA (EXAMES DE HEMOGRAMA) CONSUMO MINIMO

3123

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

VALOR TOTAL

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

PRazo DE ENTREGA (EM DIAS)

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

DESCONTO

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

FRETE

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

FATURAMENTO MINIMO

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

OBSERVAÇÃO:

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

A EMPRESA DISPONIBILIZA O CONTRATO, APENAS SE FOR FECHADO TODA A COTAÇÃO COM O MESMO

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

O ITEM NUMERO 4 A EMPRESA DISPONIBILIZA 2.500 TESTE COMO BONIFICAÇÃO

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

ITENS FALTANTES

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

ITENS ATENDIDOS

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

DADOS DO COMPRADOR

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

NOME

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

TELEFONE

1

APIJÁ

2

SOCRAM

3

CIENTICALAB

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

APIJÁ

APIJÁ

APIJÁ

E-MAIL



Alan Masahiro Nunes Sebata <alansebata@gmail.com>

Proposta Equipamentos - UPA III - Dr Alair Mafra - Anápolis Go

6 mensagens

Raphael da Costa Santos <raphael.costa@apija.com.br>
Para: "alansebata@gmail.com" <alansebata@gmail.com>

2 de junho de 2022 18:05

Boa Tarde

Segue Anexo, propostas que foram apresentadas por mim e o Gerente da Apijã

Proposta:

HEMATOLOGIA - **XN350**HEMATOLOGIA - **XN550**BIOQUIMICA - **INTEGRA 400**GASOMETRIA - **B221**COAGULAÇÃO - **ACCUCHEK PRO II**

Obrigado,

Atenciosamente

RAPHAEL COSTA SANTOS

EXECUTIVO DE VENDAS

+55 (62) 9915.5675 /ramal 5225

raphael.costa@apija.com.br

www.apija.com.br

Apijã Matriz

AV. C-205, No. 236Jardim América - Goiânia/GOCEP: 74270-020Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveoCompliance Viveo: www.viveo.com.br/#compliance**MEL**
ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO
AO CLIENTE VIVEO.

ACESSE:

www.viveo.com.br/cliente customer
care

Aviso 1: Este e-mail pode conter informações e documentos confidenciais e/ou protegidos por lei. Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que desconsidere completamente o seu conteúdo e os devolva ao seu remetente e os apague imediatamente, ficando proibida a sua cópia e/ou encaminhamento para terceiros. Aviso 2: Apesar da Viveo tomar todas as cautelas necessárias para evitar que nenhum vírus esteja presente nessa

mensagem, ela não se responsabiliza por eventuais perdas ou danos eventualmente causados por esse e-mail ou seus anexos.

5 anexos

-  **PROPOSTA COMERCIAL Nº278-2022 - UPA III- COMODATO COAGUCHECK PRO II.pdf**
403K
-  **PROPOSTA COMERCIAL Nº 275 -2022-UPA III - COMODATO XN 350.pdf**
391K
-  **PROPOSTA COMERCIAL Nº274-2022 UPA II - COMODATO XN 550.pdf**
304K
-  **PROPOSTA COMERCIAL Nº276-2022 UPA II - COMODATO B221 SEM GLU LAC.pdf**
315K
-  **PROPOSTA COMERCIAL Nº 277-2022 UPA III - LOCAÇÃO INTEGRA 400 PLUS.pdf**
327K

Raphael da Costa Santos <raphael.costa@apija.com.br>
Para: "alansebata@gmail.com" <alansebata@gmail.com>

3 de junho de 2022 17:07

Boa Tarde

Tudo bom Sr. Alan? Espero que sim

Entrando em contato para poder ver com o senhor sobre a proposta que apresentamos ontem, quinta feira.

O Senhor avaliou? Para poder seguirmos com o contrato?

RAPHAEL COSTA SANTOS**EXECUTIVO DE VENDAS**

+55 (62) 9915.5675 /ramal 5225

raphael.costa@apija.com.br

www.apija.com.br

Apijã Matriz

AV. C-205, No. 236


Jardim América - Goiânia/GO

CEP: 74270-020



Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

Compliance Viveo: www.viveo.com.br/#compliance

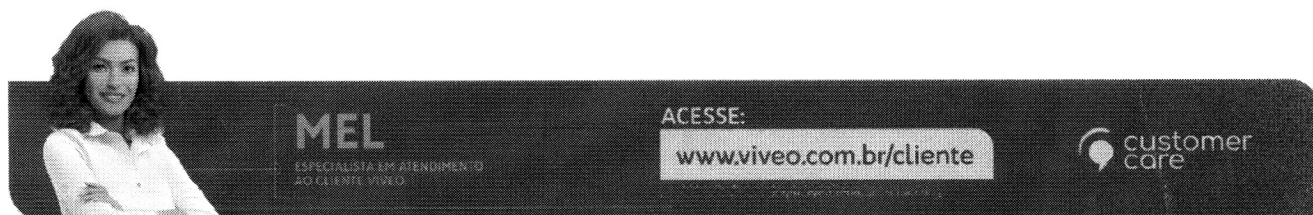

De: Raphael da Costa Santos

Enviado: quinta-feira, 2 de junho de 2022 18:05

Para: alansebata@gmail.com <alansebata@gmail.com>

Assunto: Proposta Equipamentos - UPA III - Dr Alair Mafra - Anápolis Go

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Alan Masahiro Nunes Sebata <alansebata@gmail.com>
Para: supervisordecompras.chzn@indsh.org.br

14 de junho de 2022 17:42

Segue a proposta da Empresa Apjan

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Supervisor de Compras <supervisordecompras.chzn@indsh.org.br>
Para: Alan Masahiro Nunes Sebata <alansebata@gmail.com>

14 de junho de 2022 20:05

Boa noite,

Dr. Alan,

Não veio anexo.

At.te,

Isamara.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Raphael da Costa Santos <raphael.costa@prevena.com.br>

11 de julho de 2022 17:55

Para: "alansebata@gmail.com" <alansebata@gmail.com>

Cc: Luiz Eduardo Oliveira de Paiva <luiz.paiva@prevena.com.br>, "contratos.chzn@indsh.org.br"

<contratos.chzn@indsh.org.br>, "bismarques.upaalair@indsh.org.br" <bismarques.upaalair@indsh.org.br>

Boa Tarde, Dr Alan,

Preciso do aceite neste email, para darmos continuidade no processo do Contrato.

Equipamentos:

HEMATOLOGIA - XN1000

BIOQUIMICA - INTEGRA 400

GASOMETRIA - B221

COAGULAÇÃO - ACCUCHEK PRO II

RAPHAEL COSTA SANTOS

GESTOR DE NEGÓCIOS/GO

+55 (62) 3086.5250 /ramal 5225

+55 (62) 99115-5675

raphael.costa@prevena.com.br

www.prevena.com.br


Prevena - Unidade Goiânia/GO

AV. C-205, No. 236

Jardim América


Goiânia/GO

CEP: 74270-020

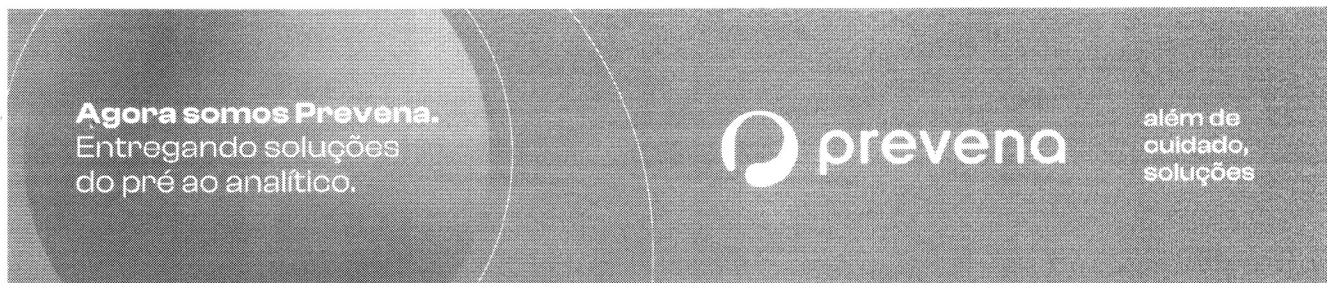

Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

Compliance Viveo: www.viveo.com.br/#compliance

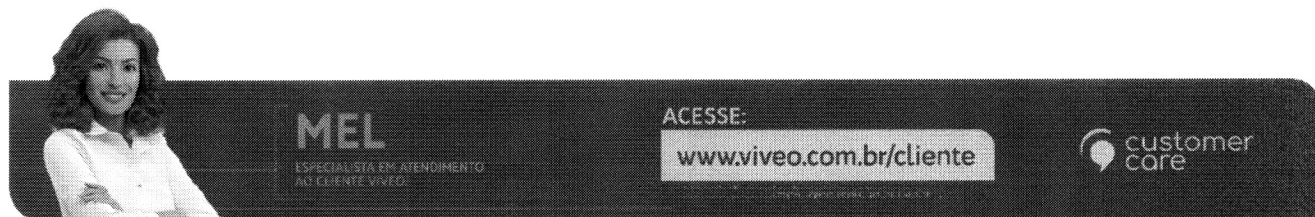

De: Raphael da Costa Santos

Enviado: quinta-feira, 2 de junho de 2022 18:05

Para: alansebata@gmail.com <alansebata@gmail.com>

Assunto: Proposta Equipamentos - UPA III - Dr Alair Mafra - Anápolis Go

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

 **PROPOSTA COMERCIAL N°278-2022 - UPA III- COMODATO COAGUCHECK PRO II.pdf**
403K

 **PROPOSTA COMERCIAL N°276-2022 UPA II - COMODATO B221 SEM GLU LAC.pdf**
315K

 **PROPOSTA COMERCIAL N° 277-2022 UPA III - LOCAÇÃO INTEGRA 400 PLUS.pdf**
327K

 **PROPOSTA COMERCIAL N°284-2022 UPA III - COMODATO XN 1000S.pdf**
321K

Alan Masahiro Nunes Sebata <alansebata@gmail.com>

11 de julho de 2022 20:11

Para: Raphael da Costa Santos <raphael.costa@prevena.com.br>

Boa noite

Aceito

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.
Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 N°. 236 Jardim América
Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás
PABX: (62)3086-5250
E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br


Goiânia, 01 de junho de 2022.

A
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra de Anápolis
Cidade: Anápolis - GO
Endereço: R. 29 de Dezembro, s/n - Vila Esperança, Anápolis - GO, 75133-450
Telefone: (62) 3902-2165
A/c: Alan

PROPOSTA COMERCIAL Nº278-2022

Item	Unid	Quant.	Descrição	Marca	Tipo
01	UND	1	Coagucheck XS Pro II	Roche	Comodato

Descrição do Equipamento: Coagucheck XS Pro II

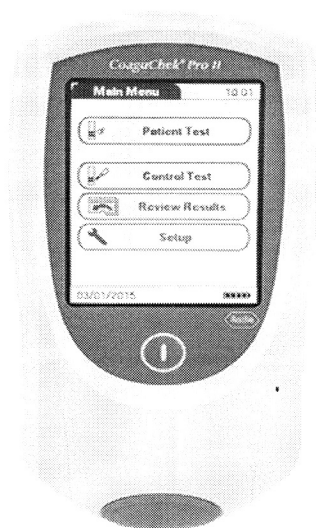


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 Nº. 236 Jardim América

Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás

PABX: (62)3086-5250

E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

2

CoaguCheck XS Pro II

O medidor de coagulação CoaguChek Pro II apresenta vários aprimoramentos para a geração anterior de dispositivos CoaguChek (CoaguChek XS Plus e CoaguChek XS Pro). Ele aproxima o laboratório do paciente no ambiente hospitalar. Além disso, continua apoiando o monitoramento da terapia com Antagonista da Vitamina K (AVK) nos segmentos profissionais, como clínicas de anticoagulação (AC) e consultórios médicos.

Dois ensaios podem ser determinados com o novo medidor CoaguChek Pro II – tempo de protrombina (PT) (com reivindicações estendidas), bem como o tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT)

O medidor de coagulação CoaguChek Pro II apresenta vários aprimoramentos para a geração anterior de dispositivos CoaguChek (CoaguChek XS Plus e CoaguChek XS Pro). Ele aproxima o laboratório do paciente no ambiente hospitalar. Além disso, continua apoiando o monitoramento da terapia com Antagonista da Vitamina K (AVK) nos segmentos profissionais, como clínicas de anticoagulação (AC) e consultórios médicos.

Dois ensaios podem ser determinados com o novo medidor CoaguChek Pro II – tempo de protrombina (PT) (com reivindicações estendidas), bem como o tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT).

Leitor de código de barras 2-D para identificação do paciente, do operador e dos controles para entrada mais rápida de ID

Pacote de bateria universal, carregando via adaptador de energia e / ou unidade base * (HBU)

Conectividade aprimorada por meio da tecnologia sem fio e / ou do exclusivo recurso de código QR

PT / INR resulta em aproximadamente 1 minuto

aPTT resulta em menos de 5 minutos

Opções de dosagem laterais e superiores com uma gota de sangue total fresco venoso, capilar ou arterial (min. 8 µL)

Clinicamente Vital

Dos andares para a sala de cirurgia para o pronto-socorro para a UTI, os resultados do aPTT e PT estão em suas mãos em tempo real

Conectividade Aprimorada

Informações críticas estão disponíveis quando e onde são mais necessárias

Conectividade sem fio e leitor de código de barras para entrada e saída digital

O recurso de código QR permite a transmissão de dados para qualquer sistema de gerenciamento de dados imediatamente, sem a necessidade de transcrever resultados para um fluxo de trabalho simplificado

Download do Adendo do WIFI.

Valor dos Insumos e Custo/Teste

Código	Item	Apresentação	Valor	Custo/teste
6688721070	CoaguChek PT 2x24 Test (es/pt/hu/el)	2x24 testes	R\$ 1.482,00	R\$ 30,88
6882382070	CoaguChek aPTT 2x24 T hu/el/es/pt/lv/sv	2x24 testes	R\$ 1.535,00	R\$ 31,98


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 Nº. 236 Jardim América

Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás

PABX: (62)3086-5250

E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

Obs: Informações Complementares:

Proposta Comercial para Comodato: Coaguchek XS Pro II

Consumo Mínimo Mensal: 02 (Duas) caixas do item CoaguChek PT 2x24- Ref: 6688721070 /02 (Duas) caixas do item CoaguChek aPTT 2x24 T - Ref: 6882382070.

Duração do Contrato: 36 (Trinta e Seis) meses

Prazo de Entrega: De 30 a 60 Dias após assinatura do Contrato.

Validade da Proposta: 10 Dias

Empresa: Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais, e Assist. Técnica Ltda CNPJ: nº 02.346.952/0001-97

End: Av. C-205 Nº236 QD:32 LT:13 CEP: 47.270.020

Bairro: Jardim América Goiânia – Goiás

End. Eletrônico: apijavendas@apija.com.br/apija@apija.com.br

Inscrição Estadual: 10.301.944-08 Inscrição Municipal: 1380109

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil Agência: 3483 – 5 Conta Corrente: 407724 – 5.


Atenciosamente;

Raphael Costa - Setor de vendas

Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Fones: 62- 3086-5250 / 62- 99115-5675

E-mail: raphael.costa@apija.com.br


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH


Goiânia, 01 de junho de 2022.


A
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra de Anápolis
Cidade: Anápolis - GO
Endereço: R. 29 de Dezembro, s/n - Vila Esperança, Anápolis - GO, 75133-450
Telefone: (62) 3902-2165
A/c: Alan

PROPOSTA COMERCIAL Nº277 -2022

Item	Unid	Quant.	Descrição	Marca	Tipo
01	UND	1	Integra 400 Plus	Roche	Locação

Descrição Equipamento: Cobas Integra 400 Plus

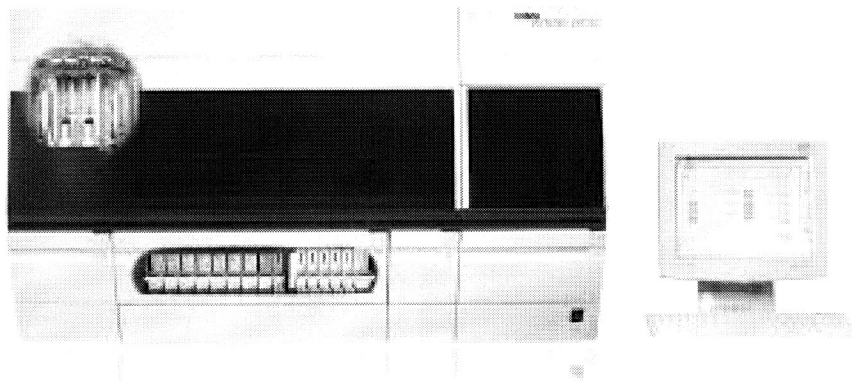


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH

Cobas Integra 400 Plus

01- COBAS INTEGRA 400 PLUS- É um analisador automático multiparamétrico de bioquímica, acesso randômico, com unidade analítica e operacional integrada. Determinações de substratos e enzimas (fotometria de absorção), proteínas específicas e drogas de abuso (turbidimetria), drogas terapêuticas (fluorescência polarizada) e ISE (sódio, potássio, cloro e lítio) permitem até 400 testes/hora. Com sistema de reagentes em cassete e software amigável, possibilita a identificação de amostras e reagentes por código de barras.

Princípio do sistema

- Randômico de acesso contínuo, integração de 4 princípios de medição e 36 testes onboard
- Fotometria de absorbância: Enzimas e substratos
- Turbidimetria: Proteínas Específicas, drogas de abuso.
- Fluorescência polarizada: Drogas Terapêuticas
- Potenciometria e Eletrodo Íon-Seletivo: Na⁺, K⁺, Cl⁻ e Li⁺

Velocidade: Até 400 testes por hora (incluindo ISE)

Tipos de Amostras: Soro, Plasma, Urina, LCR, Hemolisado e Sangue Total (HbA1c)

Gerenciamento de Amostras

- 90 tubos primários ou secundários onboard, até 6 x racks 15 posições onboard
- Posição de rack refrigerada para controles e calibradores
- Diluição e concentração automáticas de amostras
- Leitura de código de barras via scanner a laser, com reconhecimento imediato de amostras SAT

Tipos de Recipientes de Amostras: Tubos primários: 5 a 10 ml; 16x100, 13x100, 13x75mm, Microcopo Hitachi, 500µl; Microcopo padrão Hitachi, 1,5ml; Copo COBAS, 650µl; Copo Eppendorf, 1,5ml; Copo em tubo

Volume de Amostras: Tipicamente, 2 a 10µl por teste, ISE indireto 20µl, ISE direto 97µl

Tipos de Códigos de Barras: Código 128, Codabar, Código 2 de 5 interleaved, Código 39.

Capacidade de reagentes onboard


- 32 cassetes, 50-800 testes por cassete, até 8 racks de 4 cassetes onboard
- Reconstituição automática de cassete quando necessário
- Compartimento de reagentes refrigerado a 10-15°C
- Estabilidade onboard de até 3 meses, calibração normalmente a cada lote

Células de Reação: Contém 1000 cubetas descartáveis com volume de reação de 120-240µl

Interfaces do Sistema: Interface serial RS 232, bi-direcional, modem interno para acesso de remoto.

Peso: 320 kg

Requisito de Água: Até 2 litros por hora em modo de operação, tipo 1 NCCLS



Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.
Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 Nº. 236 Jardim América
Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás
PABX: (62)3086-5250
E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

Obs: Informações Complementares:

Proposta Comercial para Locação: Cobas Integra 400 Plus

Valor Mensal da Locação: R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)

Consumo Mínimo Mensal: R\$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais)

Vigência do Contrato: 36 (Trinta e Seis) Meses

Nobreak incluso

Impressora não inclusa.

Manutenções preventivas, preditivas e corretivas inclusas

Prazo de Entrega: 30 a 60 dias, após assinatura do contrato.

Validade da Proposta: 10 dias

Empresa: Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais, e Assist. Técnica Ltda CNPJ: nº 02.346.952/0001-97

End.: Av. C-205, Qd:32 Lt:13 nº 236 Cep: 74.270.020

Bairro: Jardim América Goiânia – Goiás


End. Eletrônico: apijavendas@apija.com.br/apija@apija.com.br

Inscrição Estadual: 10.301.944-08 Inscrição Municipal: 1380109

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil Agência: 3483 – 5 Conta Corrente: 407724 – 5.

Atenciosamente,

Raphael Costa - Setor de vendas
Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.
Fones: 62- 3086-5250 / 62- 99115-5675
E-mail: raphael.costa@apija.com.br


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.
Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 N°. 236 Jardim América
Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás
PABX: (62)3086-5250
E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

Goiânia, 01 de junho de 2022.

A
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra de Anápolis
Cidade: Anápolis - GO
Endereço: R. 29 de Dezembro, s/n - Vila Esperança, Anápolis - GO, 75133-450
Telefone: (62) 3902-2165
A/c: Alan

PROPOSTA COMERCIAL N°276-2022

Item	Unid	Quant.	Descrição	Marca	Tipo
01	UND	1	Cobas b221- (Sem GLU/LAC)	Roche	Comodato

Descrição Equipamento: Cobas b221



Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 N°. 236 Jardim América

Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás

PABX: (62)3086-5250

E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

01- Cobas b 221 – Analisador de Gases Sanguíneos, Eletrólitos, CO-Oximetry, Hematócrito, Metabólitos e Bilirubina.

Características:

- Calibração líquida. Dispensa o uso de cilindros de gases;
- Detecção automática de lote, validade e quantidade das soluções de calibração;
- Eletrodos sem manutenção;
- Possibilidade de utilização de Cata Coágulos (“Clo Cacher”)
- Aprovado pelo FDA para análise de pH em fluidos pleurais
- Vídeo de Treinamento
- Módulo para realização automática de controle de qualidade
- Banco de dados com grande capacidade de armazenamento, com recurso para extração de dados através de disquete.
- Programa de Auto Diagnóstico de falhas

Parâmetros medidos:

- PO₂, PCO₂, PH
- Na, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻
- Glicose, Lactato
- O₂Hb, HHb, COHb, MetHb (COOX)
- Hemoglobina total (tHb)
- Saturação de Oxigênio (SO₂)
- Hematócrito (Hct)
- Bilirrubina (Bili-COOX)
- Pressão Barométrica
- Parâmetros derivados
- Mais de 30 parâmetros calculados e impressos

Novo conceito de reagentes

- Apenas 3 frascos de reagentes:
- S1 Solução Rinse Cobas b 221 OMNI S
- S2 Fluid Pack Cobas b 221 OMNI S
- S3 Fluid Pack A Cobas b 221 OMNI S

Logística simplificada e fácil gerenciamento

Tela de toque colorida

Volume de amostras

Módulos ativados

BG – tHb/SO₂ ou COOX

BG – ISE - tHb/SO₂ ou COOX

Volume máximo de
amostra (µL)

80

110


Caio A. Milhom
Dep. de Compras
UPA AMA-INDS II



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 N°. 236 Jardim América

Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás

PABX: (62)3086-5250

E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

TABELA DE CONTROLES

ITEM	UNIDADE	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT.
01	Cx	01	Auto Trol Plus B Nível 1 Caixa C/ 40 Ampolas	Roche	R\$ 585,44
02	Cx	01	Auto Trol Plus B Nível 2 Caixa C/ 40 Ampolas	Roche	R\$ 665,81
03	Cx	01	Auto Trol Plus B Nível 3 Caixa C/ 40 Ampolas	Roche	R\$ 531,53

Informações Complementares:

Proposta Comercial para Comodato: Cobas 221

Consumo Mínimo Mensal: 300 (Trezentos) Amostras/Mês

Valor da Amostra: R\$ 18,95 (Dezoito Reais e Noventa e Cinco Centavos) Por Amostra

Duração do Contrato: 36 (Trinta e Seis) meses

Prazo de Entrega: De 30 a 120 Dias após assinatura do Contrato.

Validade da Proposta: 10 Dias

Nobreak Incluso.

Manutenções Preventivas, Corretivas e Preditivas Inclusas.

Controles de Qualidade não Inclusos.

Empresa: Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais, e Assist. Técnica Ltda CNPJ: nº 02.346.952/0001-97

End: Av. C-205 N°236 QD:32 LT:13 CEP: 47.270.020

Bairro: Jardim América Goiânia – Goiás

End. Eletrônico: apijavendas@apija.com.br/apija@apija.com.br

Inscrição Estadual: 10.301.944-08 Inscrição Municipal: 1380109

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil Agência: 3483 – 5 Conta Corrente: 407724 – 5.

Atenciosamente;

Raphael Costa - Setor de vendas

Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Fones: 62- 3086-5250 / 62- 99115-5675

E-mail: raphael.costa@apija.com.br

Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH

BG – ISE – MSS – tHb/SO₂ ou COOX

161

Inovação na introdução de amostra:
Aspiração (capilar e seringa) e injeção (seringa)

Tempo de medição das amostras (segundos)

MÓDULOS ATIVADOS	TEMPO MÉDIO DE MEDIÇÃO	
	Tempo total*	Visualização na Tela**
BG - COOX	110	76
BG - ISE - COOX	110	76
BG - ISE - MSS (Gli/Lac) - COOX	120	88

* Tempo total = tempo para a medição de uma amostra, recalibração e disponibilidade do equipamento para inserção de nova amostra.


** Tempo para visualização dos resultados apenas na tela, com possibilidade de impressão.

Tipos de amostra

- Sangue total, soro, plasma, dialisado e soluções de controle de qualidade e fluidos pleurais.

Dimensões

Largura	51,0 cm
Altura	59,0 cm
Profundidade	60,0 cm
Peso	45 kg (sem reagentes, incluindo Auto CQ)


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.
Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 N°. 236 Jardim América
Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás
PABX: (62)3086-5250
E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br


Goiânia, 13 de junho de 2022.

A
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra de Anápolis
Cidade: Anápolis - GO
Endereço: R. 29 de Dezembro, s/n - Vila Esperança, Anápolis - GO, 75133-450
Telefone: (62) 3902-2165

PROPOSTA COMERCIAL N°284-2022

ITEM	UND	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	TIPO
01	UND	1	XN-1000s	Roche	Comodato

Descrição do Equipamento: XN 1000s

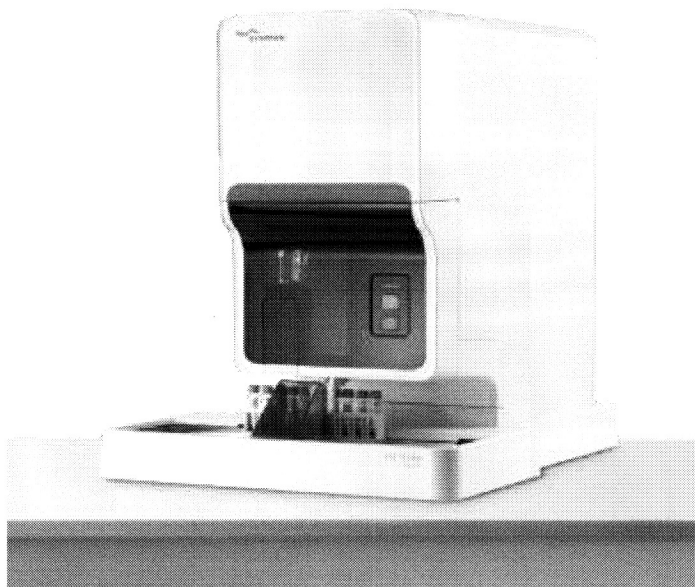


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 N°. 236 Jardim América

Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás

PABX: (62)3086-5250

E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

Descritivo do Equipamento XN 1000s

A Série-XN foi ampliada com mais uma configuração que oferece a mesma plataforma analítica para laboratórios com menor grau de complexidade e que não necessitam da função rerun e Reflex de forma automática. O XN-1000-S utiliza o método de Citometria de fluxo fluorescente para a contagem de eritoblastos (NRBC) e realização da diferencial de 6-partes que inclui o parâmetro de granulócitos imaturos (IG) em todas as diferenciais leucocitárias. Esse analisador pode representar um marco na modernização do laboratório por padronizar o fluxo de trabalho e permitir acesso a futuros upgrades.

Parâmetros Reportáveis: WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT (PLT-I), NRBC%, NRBC#, RDW-SD, RDW-CV, VPM, NEUT #, %; LINFO #, %; MONO #, %; EO #, %; BASO #, %; IG #, %.

Volume de Amostras: Módulo - XN Sangue total: 88 µL **Modo pré-diluído:** 70 µL

Controle de qualidade: Sangue total

WBC: 0,00 - 440,00 x 10³/µL

RBC: 0,00 - 8,60 x 10/µL

HGB: 0,00 - 26,0 g/dL

HCT: 0,00 - 75%

PLT: 0 - 5.000 x 10³/µL.

Controle de Qualidade:

99 arquivos completos de controle de qualidade com gráficos de Levey-Jennings para cada módulo analítico XN.

XN Check: produto de controle de qualidade com três níveis para todos os parâmetros do hemograma, diferencial leucocitária, incluindo contagem de eritoblasto, granulócitos imaturos e plaquetas.

Programa Insight: programa de controle de qualidade inter-laboratorial que avalia e fornece um relatório do desempenho dos analisadores comparados com a média de grupos de laboratórios.

Memória 10.000 resultados

Descrição - Automatização compacta - Regras de decisão clínica onboard

Velocidade: Até 100 amostras/horas

Dimensões: 64,5(L) x 85,6 (A) x 75,4 (P) [cm]

Gerenciamento de reagentes:

Identificação por sistema de radiofrequência (tecnologia RFID) que simplifica o processo de carregamento de reagentes.

Cada reagente tem um código com uma cor específica na embalagem e na tela do programa do computador para facilitar sua identificação.


Caio A. Milhomen
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Produtos Hospitalares Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Av.: C 205, Qd: 32 Lt: 13 Nº. 236 Jardim América

Cep: 74-270 - 020 Goiânia – Goiás

PABX: (62)3086-5250

E – mail : apija@apija.com.br/apijavendas@apija.com.br

Obs: Informações Complementares:

Proposta Comercial para Comodato: XN 1000s

Consumo Mínimo Mensal: 3.123 (Três Mil Cento e Vinte e Três) Amostras/Mês

Valor da Amostra: R\$ 4,40 (Quatro Reais e Quarenta Centavos) Por Amostra

Vigência de contrato: 36 (Trinta e Seis) meses

Prazo de Entrega: 30 a 60 dias após assinatura do contrato

Incluso 01 (Uma) trinca (Níveis 01,02 e 03) de controle de Qualidade.

Nobreak Incluso

Impressora não inclusa

Manutenção preditiva, preventiva e corretiva inclusa.

Validade da Proposta: 10 Dias.

Empresa: Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais, e Assist. Técnica Ltda CNPJ: nº 02.346.952/0001-97

End: Av. C-205 Nº236 QD:32 LT:13 CEP: 47.270.020

Bairro: Jardim América Goiânia – Goiás

End. Eletrônico: apijavendas@apija.com.br/apija@apija.com.br

Inscrição Estadual: 10.301.944-08 Inscrição Municipal: 1380109

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil Agência: 3483 – 5 Conta Corrente: 407724 – 5.


Atenciosamente;

Raphael Costa - Setor de vendas

Apijã Produtos Hospitalares, Laboratoriais e Assistência Técnica Ltda.

Fones: 62- 3086-5250 / 62- 99115-5675

E-mail: raphael.costa@apija.com.


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



SOCRAM

SOCRAM MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.137.950/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.121.970-9

Goiânia, 24 de maio de 2022

Ao
Instituto Nacional de Desenvolvimento SO
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Pedro Leopoldo – MG

A/C: Sr. Francisco

A Socram Máquinas e Equipamentos Ltda, na qualidade de representante e distribuidor exclusivo dos produtos solicitados, apresenta sua proposta para fornecimento dos equipamentos abaixo à serem instalados na UPA Dr. Alair Mafra Andrade - Anápolis/GO, e demais características técnicas e operacionais a seguir especificadas:

1-Coagulômetro semi- automático, Marca Erba, Modelo ECL 412 4 canais:

- Valor mensal do aluguel: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
- Bonificação mensal: 300T (trezentos testes) para TAP e TTPA;
- Incluso: Manutenção Preventiva, Corretiva e Plasma controle
- Contrato mínimo: 36 (trinta e seis) meses
- O Equipamento será instalado diretamente na bancada do laboratório;
- Entrega: Imediato a 20 dias;
- Assistência Técnica e Científica permanente;
- Validade da Proposta: 07 (sete) dias.

2- Analisador de Íons Seletivos, Marca Erba, Modelo E C90:


- Valor do teste: R\$ 5,56T (cinco reais e cinquenta e seis centavos) para uma rotina de 1.500 testes/mês;
- Contrato mínimo: 36 (trinta e seis) meses;
- Incluso: Manutenção Preventiva e Corretiva;
- O Equipamento será instalado diretamente na bancada do laboratório;
- Entrega: Imediato a 20 dias;
- Assistência Técnica e Científica permanente;
- Validade da Proposta: 07 (sete) dias.

3- Gasômetro, Marca Labtest, Modelo i15:

- Valor do teste: R\$ 24,19T (vinte quatro reais e dezenove centavos) para uma rotina de 1.500 testes/mês;
- Contrato mínimo: 36 (trinta e seis) meses;
- Incluso: Manutenção Preventiva e Corretiva
- O Equipamento será instalado diretamente na bancada do laboratório;
- Entrega: Imediato a 20 dias;
- Assistência Técnica e Científica permanente;
- Validade da Proposta: 07 (sete) dias

3- Analisador Hematológico de 05 partes, Marca Erba, Modelo Elite 580:

- Valor mensal do aluguel: R\$ 11.000,00 (onze mil reais);


Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH

Avenida Castelo Branco, n.º 1097 – Setor Coimbra – Goiânia – Goiás – CEP: 74.533-010.
site: vendas@socram.com.br Telefax.: +55 (62) 3946.4866



SOCRAM MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.137.950/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.121.970-9

- Bonificação mensal: 2.500T (dois mil e quinhentos testes);
- Incluso: Manutenção Preventiva, Corretiva e Sangue Controle;
- Contrato mínimo: 36 (trinta e seis) meses
- O Equipamento será instalado diretamente na bancada do laboratório;
- Entrega: Imediato a 20 dias;
- Assistência Técnica e Científica permanente;
- Validade da Proposta: 07 (sete) dias.

3- Analisador de Bioquímica e Turbidimetria, Marca Erba, Modelo XL 640:

- Valor mensal do aluguel: R\$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais);
- Bonificação mensal: 10.000T (dez mil testes)
- Incluso: Manutenção Preventiva, Corretiva, Calibradores, Controles e Soluções;
- Contrato mínimo: 36 (trinta e seis) meses;
- O Equipamento será instalado diretamente na bancada do laboratório;
- Entrega: Imediato a 20 dias;
- Assistência Técnica e Científica permanente;
- Validade da Proposta: 07 (sete) dias.

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

Tattiana C. Labre Muniz
Socram Máq. Apar. e Equip. Ltda
Fone: (62) 39486-48669

Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH



Assunto: **Fwd: Proposta Comodato dos Aparelhos exames Laboratoriais**
De: Alan Masahiro Nunes Sebata <alansebata@gmail.com>
Para: <supervisordecompras.chzn@indsh.org.br>
Data: 14/06/2022 16:29

----- Forwarded message -----

De: **Hugo Leonardo de Souza Albuquerque** <hugo.albuquerque@dasa.com.br>
Date: ter., 14 de jun. de 2022 às 16:20
Subject: RES: Proposta Comodato dos Aparelhos exames Laboratoriais
To: Alan Masahiro Nunes Sebata <alansebata@gmail.com>

Boa tarde!

Conforme conversa via telefone, segue a negativo do orçamento para prestação de serviços Laboratoriais

Prezado Sr. Alan Sebata, ótima tarde!

Tudo bem?

Conforme eu lhe expliquei por telefone, devido ao volume de exames ficar um pouco baixo da nossa régua mínima de atendimento, que seria de pelo menos 30.000 exames mês, para que nós possamos estar montando um NTH – Núcleo Técnico Hospitalar, infelizmente nós não vamos conseguir lhe apresentar uma proposta comercial com um preço atrativo e com isso estaremos declinando desta solicitação.

Obs.: Se vocês tivessem uma outra operação que nós pudéssemos juntar, poderíamos estar revendo a nossa posição.

Desde já me coloco a vossa disposição, para o que for preciso.

Atenciosamente,

Hugo Albuquerque

Executivo Comercial

hugo.albuquerque@dasa.com.br


+55 (11) 2626-4501

+55 (81) 99262-9045

Alameda Caiapós, 84 - Tamboré
Barueri/SP

Acesse a nossa landing page:

<http://comercial.cientificalab.com.br>



Caio A. Milhomem
Dep. de Compras
UPA AMA-INDSH